

SONDE URINAIRE

PLANCHE 1/2

Associez chaque pictogramme à sa définition

RUCHE OR

En. Balloon Catheter
Fr. Sonde à ballonnet
Es. Sonda con Balon
It. Cateter con palloncino
Pt. Sonda com balao
De. Ballonkatheter
Sv. Ballongkateter

MD

RUCHE OR

REF 0604-H

SIZE Ch. **14** O. D. 4,7 mm / 5-10ml

Qty **10**

LOT 060642218-06

2021-04-31

2024-08-31

STERILE R

CE 6789

GROUPTELEMEX SAS
Jalan Perkusinah
38000 Kamunting
CHINE

EC REP GROUPTELEMEX SAS
Bd de la légèreté
44000 Nantes Cedex
FRANCE

Telemex®

UDI

(1)	1257851856531
(17)	240831
(11)	210431
(10)	060642218-06

Nom commercial du
DM

Ne pas réutiliser, usage
unique

Consulter les
instructions
d'utilisation

Référence catalogue

Ne pas utiliser si
l'emballage est
endommagé ou ouvert

Numéro de lot du
fabricant

Date limite d'utilisation

Dispositif médical

Identification unique
de dispositif

Ne pas restériliser

Attention : précautions
ou restrictions
d'utilisation

Descriptif du DM

Représentant autorisé
dans l'Union
européenne

Absence de latex

Conserver au sec

Date de fabrication


Tenir à l'écart de la
lumière du soleil ou
d'autres sources
lumineuses

Fabricant

Stérilisé par irradiation

Marquage de
conformité
européenne
et numéro d'identification
de l'organisme notifié

PLANCHE 1/2

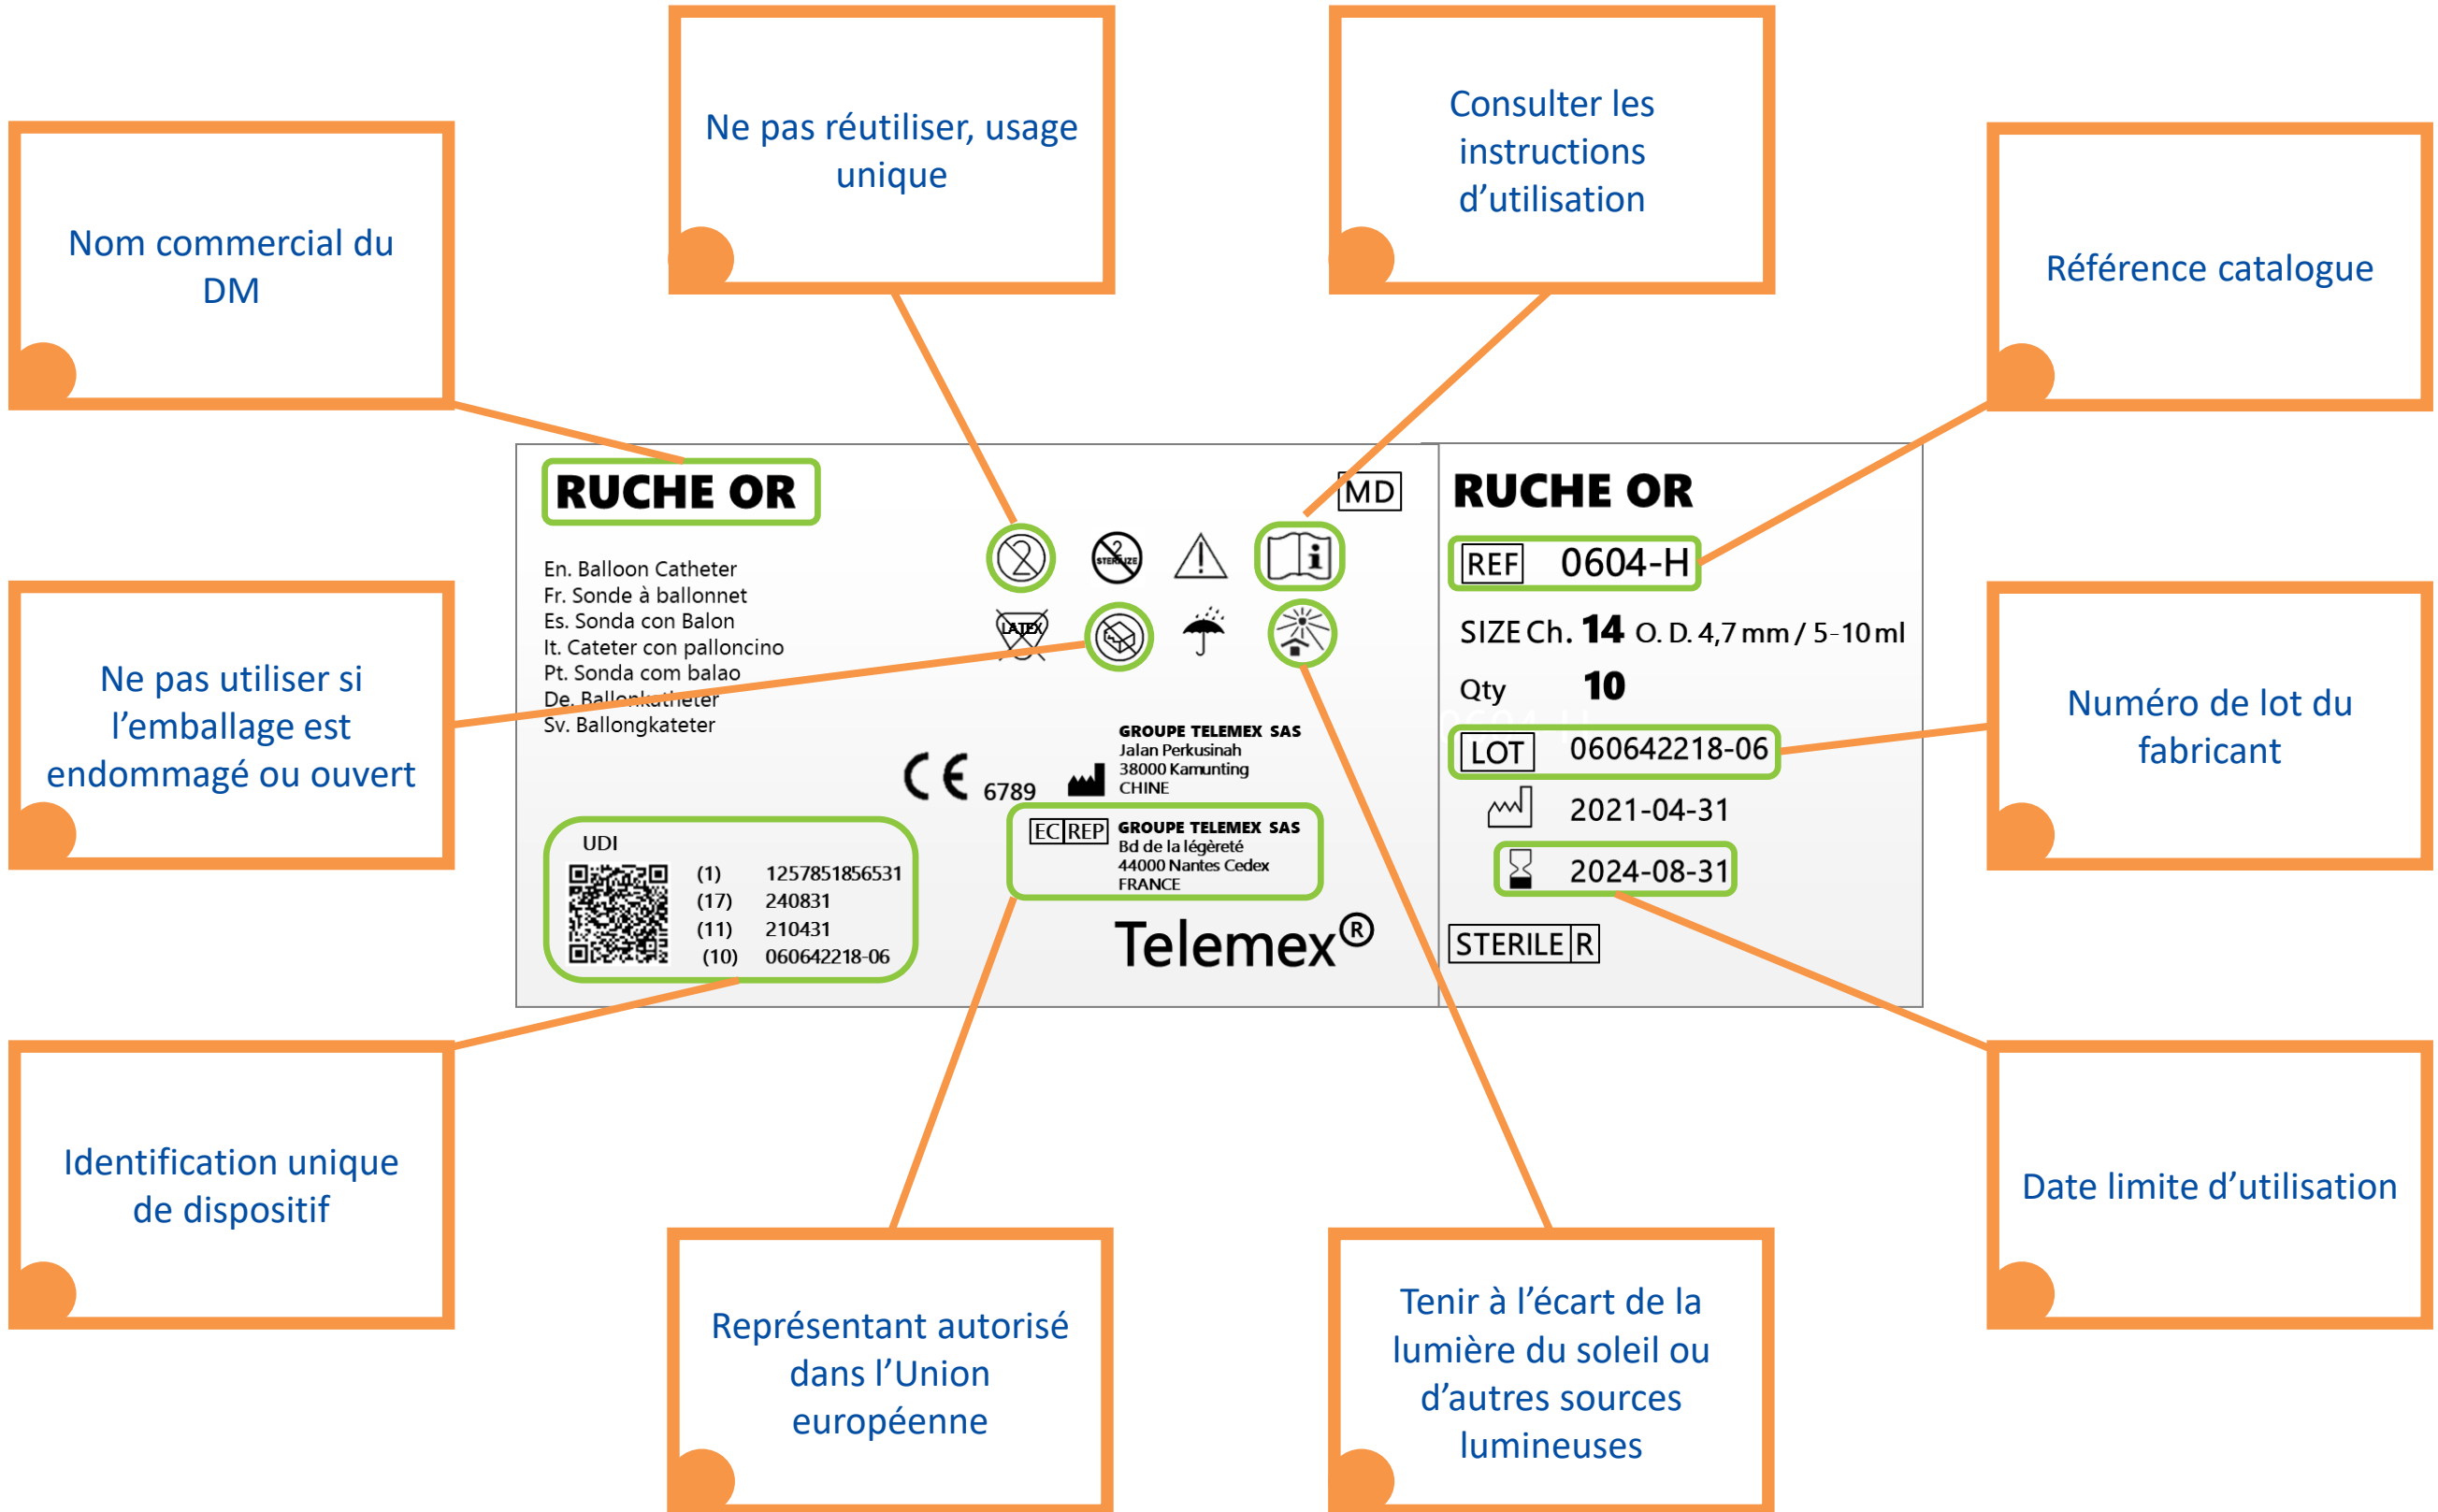

Nom commercial du DM

Ne pas réutiliser, usage unique

Consulter les instructions d'utilisation

Référence catalogue

RUCHE OR

En. Balloon Catheter
Fr. Sonde à ballonnet
Es. Sonda con Balon
It. Cateter con palloncino
Pt. Sonda com balao
De. Ballonkatheter
Sv. Ballongkateter



MD

RUCHE OR

REF 0604-H

SIZE Ch. **14** O. D. 4,7 mm / 5-10ml

Qty **10**

LOT 060642218-06

2021-04-31

2024-08-31

STERILE R

Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé ou ouvert

Numéro de lot du fabricant

Identification unique de dispositif

UDI



(1) 1257851856531
(17) 240831
(11) 210431
(10) 060642218-06

EC REP

GROUPE TELEMEX SAS
Bd de la légèreté
44000 Nantes Cedex
FRANCE

Telemex®

CE 6789


GROUPE TELEMEX SAS
Jalan Perkusinah
38000 Kamunting
CHINE

Représentant autorisé dans l'Union européenne

Tenir à l'écart de la lumière du soleil ou d'autres sources lumineuses

Date limite d'utilisation

PLANCHE 2/2

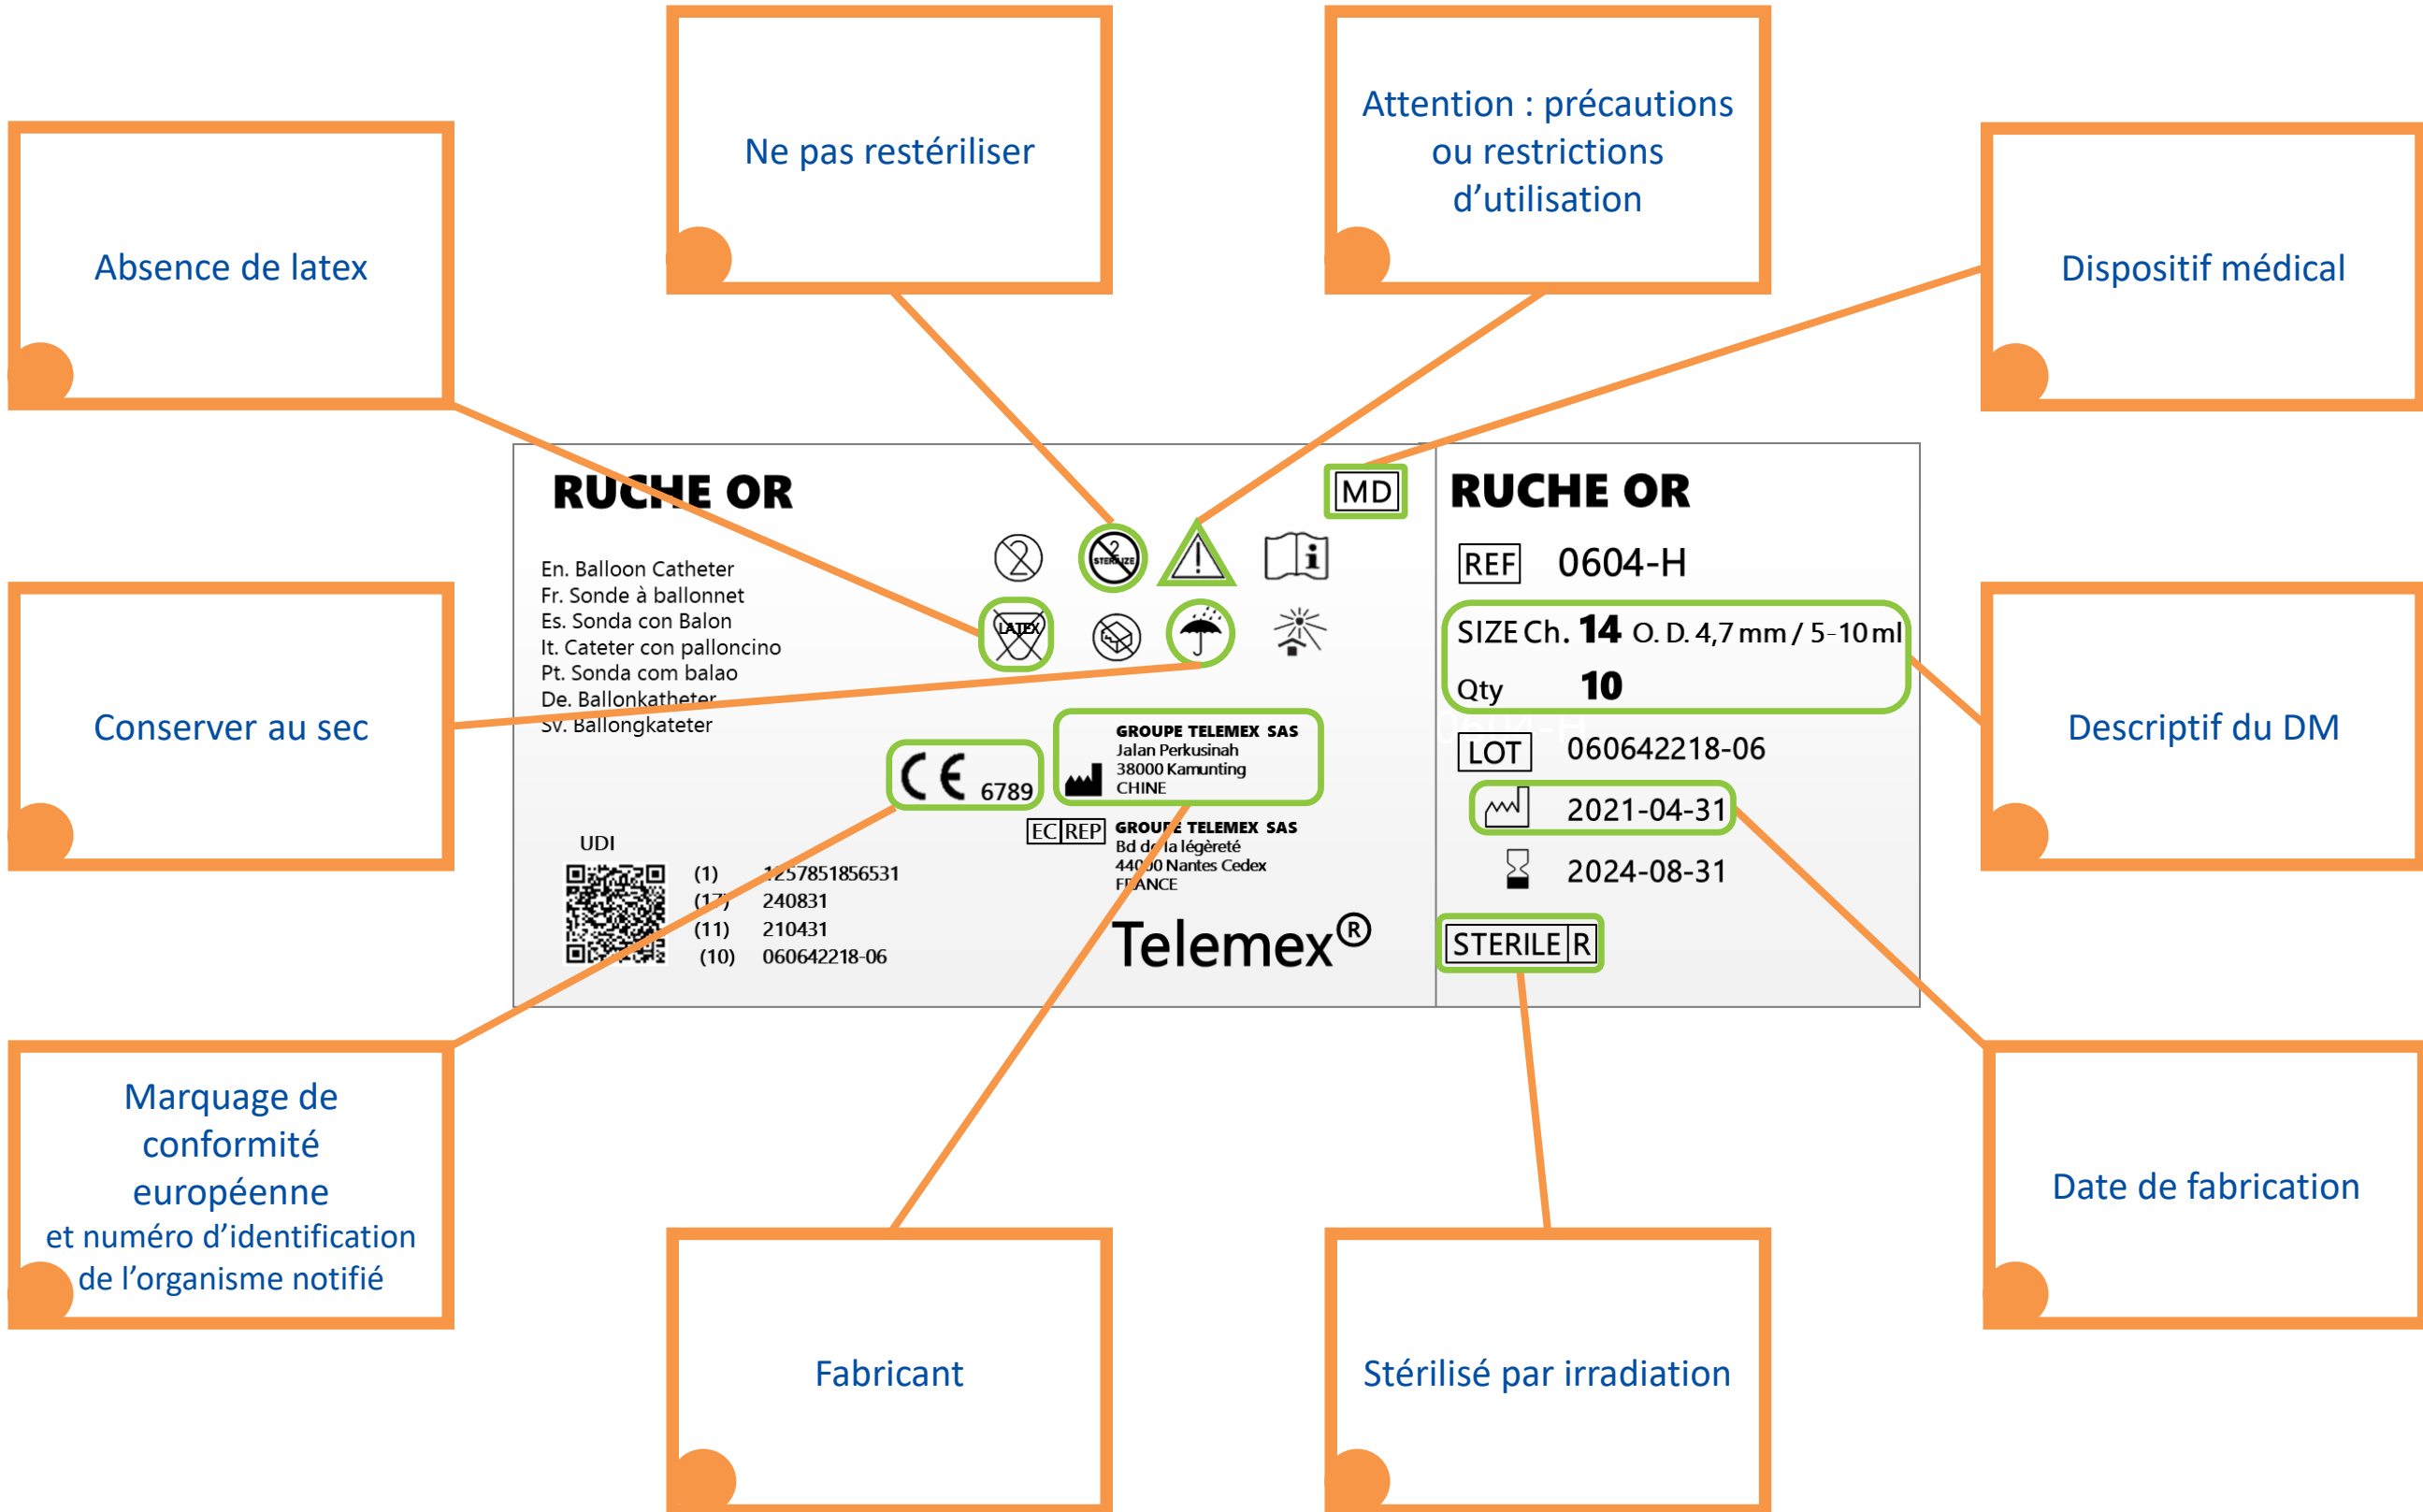

Absence de latex

Ne pas restériliser

Attention : précautions
ou restrictions
d'utilisation

Dispositif médical

Conserver au sec

Descriptif du DM

Marquage de
conformité
européenne
et numéro d'identification
de l'organisme notifié

Date de fabrication

Fabricant

Stérilisé par irradiation

RUCHE OR

En. Balloon Catheter
Fr. Sonde à ballonnet
Es. Sonda con Balon
It. Cateter con palloncino
Pt. Sonda com balao
De. Ballonkatheter
Sv. Ballongkateter



MD

RUCHE OR

REF 0604-H

SIZE Ch. **14** O. D. 4,7 mm / 5-10ml

Qty **10**

LOT 060642218-06

2021-04-31

2024-08-31

STERILE R

CE 6789

GROUPE TELEMEX SAS
Jalan Perkusinah
38000 Kamunting
CHINE

EC REP **GROUPE TELEMEX SAS**
Bd de la légèreté
44000 Nantes Cedex
FRANCE

Telemex®

UDI



(1) 1257851856531
(17) 240831
(11) 210431
(10) 060642218-06